



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641
tel. 15 864-85-04

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl




Znak DZPiZ-380-36/2020

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego" w ramach projektu numer RPSW.07.03.00-26-0005/19 pn.: „Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie”.

- Wykonawca** – Pakiet nr 1 - zestaw kolumn gazów medycznych - Kolumna przyłóżkowa sufitowa jednostanowiskowa – 1 szt.: Pkt. nr 10: Czy Zamawiający dopuści do przetargu kolumny, w których ściany głowicy pomalowane są na kolor 9003 z palety RAL? Jest to uniwersalny oraz praktyczny kolor stosowany w sprzęcie medycznym.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
- Wykonawca** – Pakiet nr 1 - zestaw kolumn gazów medycznych: Kolumna przyłóżkowa sufitowa jednostanowiskowa – 1 szt.: Pkt. nr 17: Czy Zamawiający dopuści do przetargu kolumnę, w której całkowita szerokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego wynosi 298 mm, Jest to wymiar minimalnie odbiegający od wymaganego.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
- Wykonawca** – Pakiet nr 1 - zestaw kolumn gazów medycznych - Kolumna przyłóżkowa sufitowa jednostanowiskowa – 1 szt.: Pkt. nr 22: Czy Zamawiający dopuści do przetargu kolumnę wyposażoną w gniazda elektryczne w których wystającym elementem jest klapka, która stanowi dodatkową ochronę przed zachlapaniem (IP44 – ochrona bryzgoszczelności) oraz gniazda teletechniczne typu RJ 45 cat.6 - gniazda nie wystają poza obrys ścinaki konsoli o więcej niż 4 mm?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
- Wykonawca** – Pakiet nr 1 - zestaw kolumn gazów medycznych - Kolumna przyłóżkowa sufitowa jednostanowiskowa – 1 szt. – Pkt. nr 25: Czy Zamawiający dopuści kolumny, w której półka szuflady ma wymiar 430 X 480 mm, oraz zastosowano uchwyt wpuszczony w czoło szuflady dzięki temu szuflada jest szczelnie zamknięta.

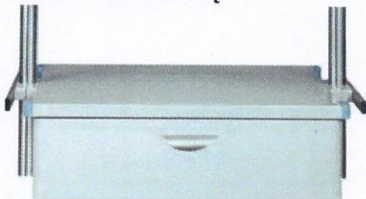

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.


5. **Wykonawca** – Pakiet nr 1 - zestaw kolumn gazów medycznych - Kolumna przyłóżkowa sufitowa dwustanowiskowa – 2 szt. Pkt. nr 10: Czy Zamawiający dopuści do przetargu kolumny, w których ściany głowicy pomalowane są na kolor 9003 z palety RAL? Jest to uniwersalny oraz praktyczny kolor stosowany w sprzęcie medycznym.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
6. **Wykonawca** – zestaw kolumn gazów medycznych, Kolumna przyłóżkowa sufitowa dwustanowiskowa – 2 szt. – Pkt. nr 17: Czy Zamawiający dopuści do przetargu kolumny, w której całkowita szerokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego wynosi 298 mm, Jest to wymiar minimalnie odbiegający od wymaganego.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
7. **Wykonawca** – Pakiet nr 1 - zestaw kolumn gazów medycznych, Kolumna przyłóżkowa sufitowa dwustanowiskowa – 2 szt., – Pkt. nr 22: Czy Zamawiający dopuści do przetargu kolumny wyposażona w gniazda elektryczne w których wystającym elementem jest klapka, która stanowi dodatkowa ochronę przed zachlapaniem (IP44 – ochrona bryzgoszczelności) oraz gniazda teletechniczne typu RJ 45 cat.6 - gniazda nie wystają poza obrys ścinaki konsoli o więcej niż 4 mm?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
8. **Wykonawca** – Pakiet nr 1 - zestaw kolumn gazów medycznych, Kolumna przyłóżkowa sufitowa dwustanowiskowa – 2 szt., Pkt. nr 25: Czy Zamawiający dopuści kolumny, w której półka szuflady ma wymiar 430 X 480 mm, oraz zastosowano uchwyt wpuszczony w czoło szuflady dzięki temu szuflada jest szczelnie zamknięta.



Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

9. **Wykonawca** – Pakiet nr 2 - aparat do wysokoprzepływowej terapii nosowej wraz z osprzętem – 2 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do terapii HFNC (HFNO) firmy Masimo TNI softFlow 50 o następujących parametrach technicznych: - Urządzenie z wbudowanym mikserem gazów, pozwalającym na precyzyjne ustawienie FiO2 w zakresie co najmniej 21-100%, - Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu FiO2. Zakresy ustawień przepływów: 10-60 l/min, zmiana co 0,5 l/min., - Stężenie tlenu w zakresie od 21 % do 100 % (alarmy dolnej i górnej granicy stężenia tlenu), - Unikalna konstrukcja urządzenia nie wymaga dezynfekcji termicznej pomiędzy pacjentami. , System wymagający użycia jednopacjentowego filtra przeciwwirusowego i przeciwbakteryjnego stosowany przez systemem nawilżenia oraz układem/setem pacjenta co stanowi dodatkową skuteczną ochronę przed zakażeniem , w tym Covid-19 i dodatkowo powoduje, że nie ma potrzeby dezynfekcji urządzenia pomiędzy pacjentami. Z możliwością przyciszenia alarmu z poziomu menu. , Waga 5,6 kg (sam aparat). Wymiary urządzenia : 320 mm x 320 mm x 210. Wózek jezdny wyposażony w półkę z systemem mocowania, wieszaki do pojemników z płynami infuzyjnymi, koszyk oraz podstawę jezdną z 5 kółkami. Urządzenie nie wymaga stosowania układów oddechowych tylko setów dedykowanych dla 1 pacjenta, prosimy o dopuszczenie setów dedykowanych dla 1 pacjenta, złożonych z:
- filtr jednopacjentowy p. wirusowy i p. bakteryjny – dedykowany na 24 h
- komora nawilżacza samo napełniająca się - do stosowania przez 7 dni u jednego pacjenta
- jednopacjentowy łącznik/mostek powietrzny - oddechowy - do stosowania przez 7 dni u jednego pacjenta
Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z zakresem przepływu 10 do minimum 60l/min. Dostępna w 4 rozmiarach: mały przepływ 20l/min, standard przepływ max. 25l/min, Standard-Plus 35l/min, duży max.50l/min, do wyboru przez Zamawiającego z łatwą identyfikacją zakresu przepływu. Do stosowania przez 15 dni dla jednego pacjenta

dy

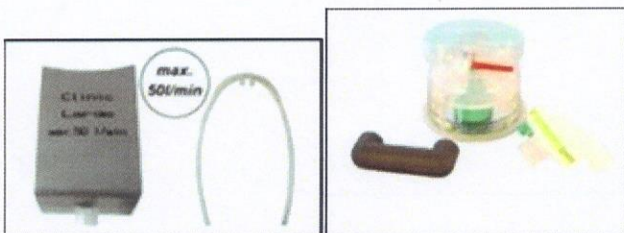

Łącznik tracheostomijny do terapii tlenowej, przystosowany do współpracy z dedykowanymi setami.

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.

10. **Wykonawca** – Pakiet nr 2 - aparat do wysokoprzepływowej terapii nosowej wraz z osprzętem – 2 szt.:

Czy Zamawiający oczekuje urządzenia, które ma być efektywnie i bezpiecznie stosowane również w hiperkapnii (potwierdzone badaniami klinicznymi)?

Odpowiedź – Nie.

11. **Wykonawca** – Pakiet nr 2 - aparat do wysokoprzepływowej terapii nosowej wraz z osprzętem – 2 szt.

Czy urządzenie ma skutecznie wypłukiwać CO₂ dzięki nie robieniu przerw przepływu podczas wydechu pacjenta?

Odpowiedź – nie.

12. **Wykonawca** – Pakiet nr 2 - aparat do wysokoprzepływowej terapii nosowej wraz z osprzętem – 2 szt.

Czy Zamawiający wymaga dodatkowego filtra antybakteryjnego i antywirusowego, dedykowanego dla jednego pacjenta jako dodatkową prewencję przed zakażeniami? System wymagający użycia jednopacjentowego filtra przeciwwirusowego i przeciwbakteryjnego stosowany jest pomiędzy systemem nawilżenia a układem/setem pacjenta

Odpowiedź – Nie.

13. **Wykonawca** – Pakiet Nr 1 Lp. 10: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie konsoli w kolorze medycznej bieli, uniwersalnym kolorze najczęściej stosowanym w tego typu urządzeniach.

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

14. **Wykonawca** – Pakiet Nr 1 Lp. 18: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie całkowitej głębokości konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego wynoszącej 186,6 mm. Pragniemy zauważyć, iż różnica względem opisanych w specyfikacji wymiarów wynosi 4,4 mm, co nie stanowi znaczącej różnicy oraz nie wpływa na walory użytkowe urządzenia.

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

15. **Wykonawca** – Pakiet Nr 1 Lp. 23, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie profilu zintegrowanego z konsolą nieznacznie wystającego poza jej obrys. Pragniemy zauważyć, iż zapewnia on stabilne mocowanie półki oraz nie wpływa na walory użytkowe urządzenia.

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

16. **Wykonawca** – Pakiet Nr 1 Lp. 23: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania pod postacią dwóch prostokątnych profili montażowych, umieszczonych w środkowej części konsoli po dwóch stronach, umożliwiających bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości, wystających nieznacznie poza obrys konsoli. Półki i szuflady z możliwością regulacji wysokości przez użytkowników. Pragniemy zauważyć, iż takie rozwiązanie zapewnia o wiele stabilniejsze mocowanie półki oraz nie wpływa na walory użytkowe urządzenia.

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

Staszów, dnia 28.01.2021 r.

Zatwierdzam:
Dyrektor SPZZOZ w Staszowie

Z up **DYREKTORA**

Tomasz Zych
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych